


HOLOGIC®

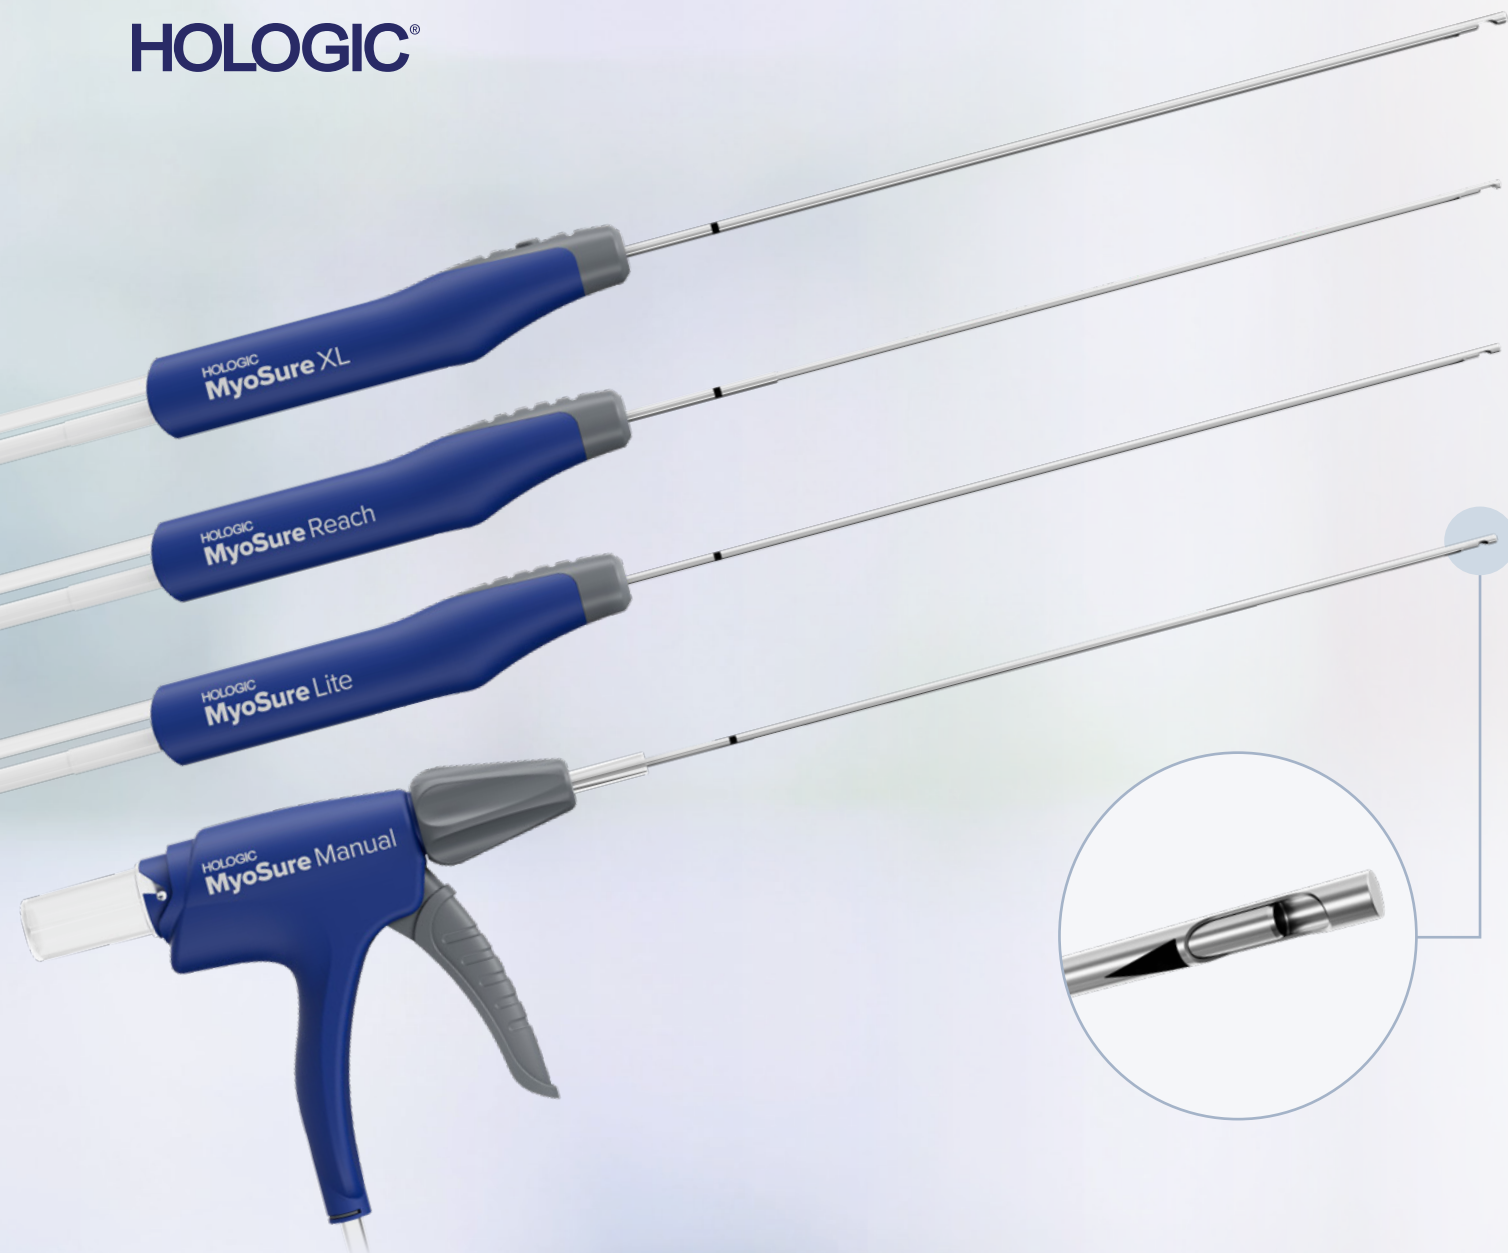

MyoSure®

Dispositifs d'élimination des tissus

Réaliser une variété de procédures et traiter un large éventail de pathologies intra-utérines

Des soins simples, efficaces et précis pour les patients grâce à une approche personnalisée basée sur la pathologie

Simplifiez la norme de soins avec la gamme de dispositifs d'élimination des tissus **MyoSure**

SIMPLE

Facilitez l'utilisation pour le personnel grâce à un système à mettre en place et prêt à l'emploi avant une procédure

EFFICACE

Améliorez l'efficacité et la cohérence de vos procédures* et réalisez potentiellement des économies en utilisant le dispositif approprié pour chaque intervention intra-utérine

PRÉCIS

Améliorez la quantité et la qualité des échantillons de tissus prélevés¹²



COMPATIBLE AVEC
Omni, **Fluent**
et **Fluent Pro**



	AMBULATOIRE		BLOC OPÉRATOIRE	
	MyoSure Manual	MyoSure Lite	MyoSure Reach	MyoSure XL
Lieu d'intervention	AMBULATOIRE		BLOC OPÉRATOIRE	
Caractéristiques	Conçu pour la polypectomie ambulatoire et les biopsies ciblées, avec un fonctionnement manuel à partir de la pièce à main et d'un système d'aspiration intégré, ce qui élimine le besoin d'aspiration externe ³	Facilite le prélèvement de tissus grâce à la biopsie visuelle ⁴	Permet la résection de zones difficiles d'accès, notamment dans le tiers supérieur de la cavité utérine ⁴	Conçu pour un meilleur contact avec les tissus et une résection plus efficace grâce à la plus grande fenêtre de coupe d'une lame hystéroscopique ⁴
Procédures	• Polypectomie d'un maximum de trois polypes de 1 cm • Biopsie endométriale ciblée	• Biopsie endométriale ciblée • Polypectomie ≤ 3 cm	• Polypectomie (toutes tailles) • Myomectomie ≤ 3 cm • Adhésiolyse • Ablation de la cloison utérine • Produits de conception retenus (PCR)	• Polypectomie (toutes tailles) • Myomectomie ≤ 5 cm • Adhésiolyse • Ablation de la cloison utérine • PCR
Pathologie	BIOPSIE DIRIGÉE			
	POLYPES ≤ 1 cm			
		POLYPES ≤ 3 cm		
			POLYPES > 3 cm	
			FIBROMES ≤ 3 cm	
				FIBROMES ≤ 5 cm

Demandez à votre représentant commercial une évaluation de l'hystérocopie et découvrez comment MyoSure peut améliorer l'efficacité des interventions.

Références

*Par rapport aux procédures d'échantillonnage en aveugle.

- Rosenblatt P, Barcia S, DiSciuolo A, Warda H. Improved adequacy of endometrial tissue sampled from postmenopausal women using the MyoSure Lite hysteroscopic tissue removal system versus conventional curettage. Int J Womens Health. 2017 Oct 27;9:789-794. doi: 10.2147/IJWH.S147338. PMID: 29138602; PMCID: PMC5667638.
- Franchini M, Zolfanelli F, Gallorini M, Giarrè G, Fimiani R, Florio P. Hysteroscopic polypectomy in an office setting: specimen quality assessment for histopathological evaluation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Jun;189:64-7. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.03.011. Epub 2015 Mar 12. PMID: 25879991.
- Mode d'emploi du système manuel d'élimination des tissus. AW-17560-002_009_02 (1).pdf.
- Mode d'emploi du système d'élimination des tissus. <https://www.hologic.com/package-inserts/gyn-surgical-products/myosure-tissue-removal-system-ifu-0>.

Informations de sécurité importantes

Le système MyoSure® de résection de tissus sous hystérocopie est destiné aux interventions intra-utérines hystérocopiques réalisées par des gynécologues formés pour réséquer et prélever des tissus, notamment les myomes sous-muqueux, les polypes endométriaux et les produits de conception retenus. Il n'est pas approprié pour une utilisation chez les patientes qui sont ou qui peuvent être enceintes, ou qui présentent une infection pelvienne, une tumeur maligne du col de l'utérus ou un cancer de l'utérus précédemment diagnostiqué.

Pour plus de détails sur les risques et les avantages du système d'élimination des tissus MyoSure, du système de gestion des fluides Fluent et de l'hystérocopie Omni, veuillez consulter les notices d'utilisation correspondantes.

Remarque : Le dispositif manuel MyoSure ne nécessite pas de système de gestion des fluides ou d'unité de commande MyoSure.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Hologic.

SS-00304-CAN-2201 Rév. 001 © 2024 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, MyoSure®, Omni®, Fluent®, Fluent® Pro, ainsi que The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées à l'ensemble du corps médical exerçant aux États-Unis et dans d'autres pays, et ne doivent pas être interprétées comme une promotion ou une sollicitation de produits lorsque de telles activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour en savoir plus sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez communiquer avec votre représentant local de Hologic.