

Évaluons l'évaluation clinique

Moins de 10 % des femmes ayant reçu un diagnostic clinique de travail prématuré **ont donné naissance dans les 7 jours** de l'annonce.¹

Les patientes ayant une dilatation minimale peuvent présenter un risque important d'accouchement.


De 16 % à 32 % des patientes qui étaient à < 2 cm ont accouché en < 7 jours.²

Accouchement selon l'heure et le % d'admission

Dilatation cervicale, cm	< 24 h	24 à 48 h	3 à 7 jours	Moins de 7 jours au total	>7 jours au total
0 à 1 (n = 104)	6	5	6	16	84
2 (n = 54)	13	9	9	32	68
3 (n = 29)	21	7	14	41	59
4 (n = 22)	50	9	23	82	18
5 (n = 16)	50	12	0	62	38
6 à 10 (n = 19)	89	11	0	100	0

fFN prédit la date d'accouchement de façon plus précise que l'évaluation clinique³

La dilatation cervicale et les contractions ont une faible sensibilité

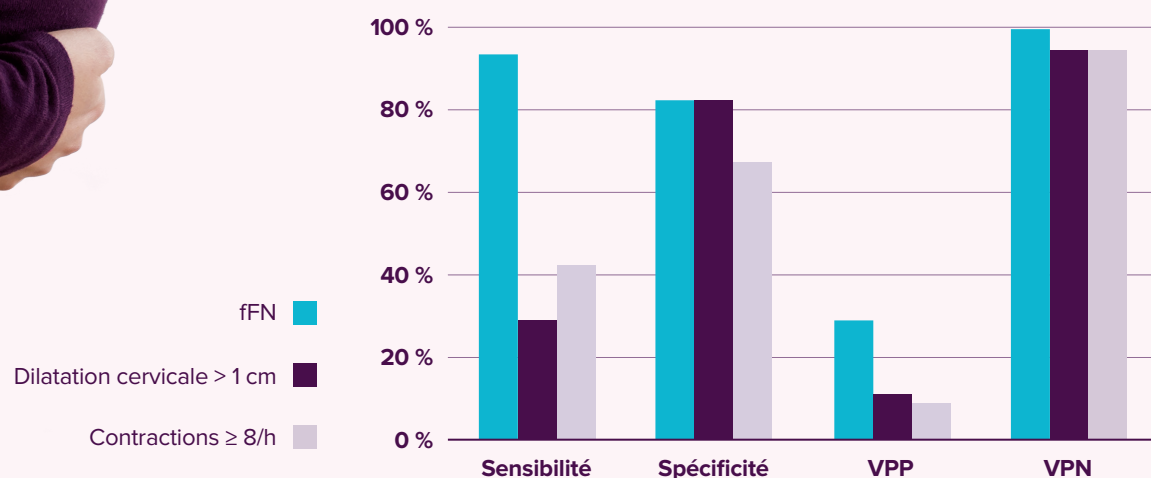

Le test rapide fFN a la meilleure sensibilité pour aider à exclure le travail prématuré.^{4,5}

RapidfFN®
for the TLip® System

Les mesures de dilatation varient considérablement d'un fournisseur à l'autre⁶

Dans une étude menée sur des obstétriciens, des résidents et des infirmières en apprentissage et perfectionnement, **seulement 56 % d'entre eux ont fourni des mesures précises**. Aucune différence significative n'a été observée quant à l'exactitude des données mesurées par les examinateurs selon leur niveau d'expérience.

Et même parmi le même fournisseur.⁶

L'étude a également révélé que **52 % des fournisseurs ont rapporté différentes mesures de dilatation** sur des simulations identiques. Aucune différence significative n'a été observée quant à la variabilité entre observateurs selon le niveau d'expérience, sauf pour les médecins ayant plus de 10 ans d'expérience, chez qui une variabilité plus élevée a été notée. Les auteurs émettent l'hypothèse que les médecins plus expérimentés effectuent moins d'exams du col de l'utérus.

Les tests de dépistage fFN
peuvent aider
à exclure **80 % des patientes**
avec des symptômes de
travail prématuré.⁴



~ **80 % des**
patientes

obtiennent un résultat négatif



~ **20 % des**
patientes

obtiennent un résultat positif

Avantages d'un résultat négatif

Un résultat négatif au test fFN signifie
que la patiente a un **< 1 % de chances**
d'accoucher dans les 14 prochains jours.

VPN élevée :

VPN pour accouchement
dans les délais suivants :

7 jours = 99,5 %

14 jours = 99,2 %

Avantages d'un résultat positif

Un résultat positif peut aider
un médecin à décider si une
patiente et son bébé pourraient
bénéficier d'interventions.

VPP utile :

VPP pour accouchement
dans les délais suivants :

7 jours = 12,7 %

14 jours = 16,7 %

Références : 1. Bulletin de pratique ACOG no 171 : Gestion de la main-d'œuvre temporaire. *Obstet Gynecol.* 2016;128:e155-64. doi:10.1097/AOG.0000000000001711. 2. How H, et coll. Cervical dilatation on presentation for preterm labor and subsequent preterm birth. *Am J Perinatol.* 2009;26:1-6. doi:10.1055/s-0028-1090586. 3. Iams JD, et coll. Fetal fibronectin improves the accuracy of diagnosis of preterm labor. *Am J Obstet Gynecol.* 1995;173(1):141-145. doi:10.1016/0002-9378(95)90182-5. 4. Rapid fFN for the TLi_Q System [encart sur l'emballage]. AW-04196-001, Rev. 004, Sunnyvale, CA: Hologic, Inc.; 2017. 5. PartoSure Test [encart sur l'emballage]. PSpI-01-01-US, Rev. A. Boston, MA: Parsagen Diagnostics, Inc.; 2018. 6. Phelps JY, et coll. Accuracy and intraobserver variability of simulated cervical dilatation measurements. *Am J Obstet Gynecol.* 1995;173 (3 Pt 1):942-945. doi:10.1016/0002-9378(95)90371-2.

Test Rapid fFN^{MD} pour le système TLi_Q^{MD}

SS-00749-CAN-FR Rév. 001 ©2020 Hologic, inc. Tous droits réservés. Hologic, Rapid fFN et les logos associés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Cette information est destinée aux professionnels de la santé et ne doit pas avoir comme but de servir de sollicitation ou de promotion de produits lorsque de telles activités sont interdites. Puisque les documents Hologic sont distribués par l'intermédiaire de sites Web, de diffusions électroniques et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible de contrôler les circonstances lors desquelles sont partagés de tels documents. Pour des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays particulier, veuillez contacter votre représentant d'Hologic local ou écrire à Canada2@Hologic.com.

RapidfFN[®]
for the TLi_Q[®] System